

**ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DEL
FORO DE ACLARACIONES DE LA
SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA No. EA-919044992-N33-2013**

MATERIAL DE LABORATORIO

En la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, siendo las 10:00 horas del día 01 de Julio del 2013, se reunieron en la sala de juntas de la Subdirección de Recursos Materiales, ubicada en Matamoros No. 520 ote., primer piso, centro de la ciudad, para efectuar la celebración del acto de Foro de Aclaraciones a las bases del concurso de la Subasta Electrónica Inversa No. **EA-919044992-N33-2013** referente a la adquisición de **Material de Laboratorio**, estando presentes los miembros del comité de adquisiciones e invitados que figuran y firman al final de la presente acta.

Este acto fue presidido por el Director Administrativo, Lic. Mario Alberto Limón Rodríguez, quién fue asistido por el(los) representantes de la(s) área(s) usuaria(s) de los bienes, cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, preside y procede a dar inicio al foro de aclaraciones de conformidad con lo establecido en los artículos 103 y 104 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León, así como a lo señalado en las bases de la subasta en referencia.

La convocante hace constar que el foro de aclaraciones dio inicio el día 26 de Junio del 2013 a las 09:00 horas, como se establece en la convocatoria y en las bases de la subasta y que se recibieron preguntas a través del portal de subastas electrónicas del gobierno del estado de Nuevo León, por los licitantes que adquirieron sus bases, las cuales se les dará respuesta a las mismas dentro del término establecido, siendo esto conforme a lo siguiente: -----

**GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO
ACTA DEL FORO ELECTRONICO DE ACLARACIONES
SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA No. 277**

El día 26/06/2013 a las 09:00 AM horas se inició el FORO ELECTRÓNICO DE ACLARACIONES de la Subasta Electrónica Inversa No. 277 y número de CompraNet EA-919044992-N33-2013 vía Internet estando registrados los siguientes participantes:

Por parte del Gobierno del Estado de Nuevo León.

Nombre: La Convocante

Que durante la sesión fue identificado como: La Convocante

Hora de Registro: 28/06/2013 09:00:32 AM


Proveedores

Nombre: DICIPA, S.A. DE C.V.

Que durante la sesión fue identificado como: Proveedor_812

Hora de Registro: 27/06/2013 22:08:23 PM

Durante el Foro Electrónico de Aclaraciones se presentaron los siguientes

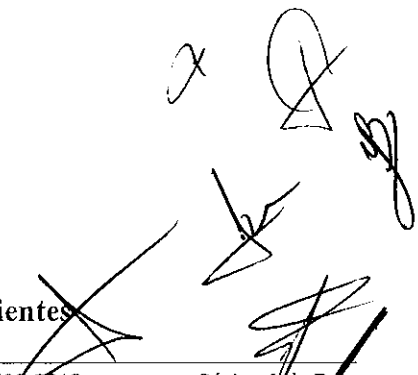

comentarios:

Participante: DICIPA, S.A. DE C.V. (Proveedor_812)

Hora del comentario: 10:08 PM

Comentario: 1 Para el renglón 14, de la partida 2, del Anexo 1, Tubo para la toma y recolección de sangre de vidrio, al vacío (13x100mm) desechable para adulto con citrato de sodio (0.5ml), liquido, tapón azul, el tapón y el interior del tubo recubierto con si

Participante: DICIPA, S.A. DE C.V. (Proveedor_812)

Hora del comentario: 10:09 PM

Comentario: silicón, volumen de drenado 4.8 – 4.9 ml, +/- 0.3ml. Esta clave ha sido descontinuada y no se encuentra en el mercado, por lo que solicitamos a la convocante se sustituya por la clave 080.909.6555 Tubo para sistema y toma de recolección de sangre

Participante: DICIPA, S.A. DE C.V. (Proveedor_812)

Hora del comentario: 10:10 PM

Comentario: de plástico pet al vacío (13x75mm) desechable para adulto con citrato de sodio 0.105 Molar (3.2%) (0.3ml) liquido, tapón azul con silicón como lubricante, volumen de drenado 2.7 a 3.0 ml (+/- 0.3ml). El rango menor establece el volumen de drenado a

Participante: DICIPA, S.A. DE C.V. (Proveedor_812)

Hora del comentario: 10:11 PM

Comentario: la altura del Altiplano Mexicano y el rango mayo el nivel del mar. Con tapón de seguridad, estéril, desechable. Caja con 100, Se acepta?

Participante: DICIPA, S.A. DE C.V. (Proveedor_812)

Hora del comentario: 10:11 PM

Comentario: 2. Para el renglón 15, de la partida 2, del Anexo 1, Tubo para la toma y recolección de sangre de vidrio al vacío (13x100mm) desechable para adulto, sin anticoagulante, tapon rojo, son silicón como lubricante, volumen de drenado 7ml (+/-0.4ml), por

Participante: DICIPA, S.A. DE C.V. (Proveedor_812)

Hora del comentario: 10:11 PM

Comentario: ser material de vidrio y considerado como riesgo de punción accidental a los usuarios, se puede sustituir y/ o agregar la clave 080.909.6506 Tubo sistema para toma y recolección de sangre, de plástico PET al vacío (13 x 100 mm) desechable para

Participante: DICIPA, S.A. DE C.V. (Proveedor_812)

Hora del comentario: 10:12 PM

Comentario: adulto sin anticoagulante, tapón rojo con silicón como lubricante y activador de coagulación, volumen de drenado 6 ml (+ 0.3 ml). Etiquetados individualmente con número de lote y fecha de caducidad. Con tapón de seguridad. Estéril. Caja con 100. Se


Participante: DICIPA, S.A. DE C.V. (Proveedor_812)

Hora del comentario: 10:12 PM

Comentario: Se acepta?

Participante: DICIPA, S.A. DE C.V. (Proveedor_812)

Hora del comentario: 10:12 PM

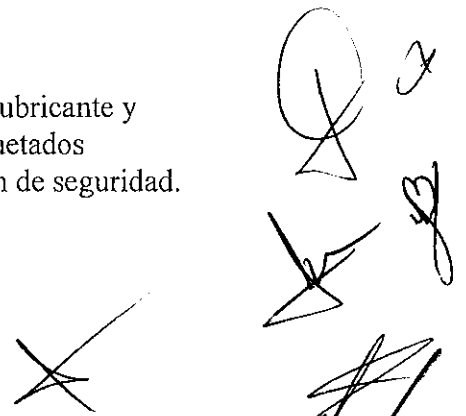

Comentario: 3. Para el renglón 18, de la partida 2, del Anexo 1, Tubo para toma y recolección de sangre de vidrio al vacío (13x75mm), desechable, para adulto, con EDTA tripotasico (0.048 ml), liquido, tapón lila con silicón como lubricante volumen de drenado 4.8

Participante: DICIPA, S.A. DE C.V. (Proveedor_812)

Hora del comentario: 10:13 PM

Comentario: -4.9 ml +/- 0.3 ml. Caja con 100, Se ha demostrado que el EDTA tripotasico provoca encogimiento de células por lo que puede alterar las determinaciones hematológicas, solicitamos a la convocante se sustituya por la clave 080.909.6498 Tubo sistema

Participante: DICIPA, S.A. DE C.V. (Proveedor_812)

Hora del comentario: 10:14 PM

Comentario: para toma y recolección de sangre, de plástico PET al vacío (13 x 75 mm) desechable para adulto con EDTA K2 (7.2 mg) aplicado por aspersión en la pared del tubo, tapón lila con silicón como lubricante, volumen de drenado 4.0 ml (+ 0.3 ml). Etiquetado

Participante: DICIPA, S.A. DE C.V. (Proveedor_812)

Hora del comentario: 10:14 PM

Comentario: individualmente con número de lote y fecha de caducidad. Con tapón de seguridad. Estéril. Caja con 100 tubos. Se acepta?

Participante: DICIPA, S.A. DE C.V. (Proveedor_812)

Hora del comentario: 10:16 PM

Comentario: 4. El renglón 11, de la partida 2 tubo de hule para ligar a los pacientes en el momento de puncionar, de látex, color ámbar, diámetro de 5mm, solicitamos a la convocante se sustituya por torniquete strech libre de látex, caja con 25 piezas. Se acept

Participante: DICIPA, S.A. DE C.V. (Proveedor_812)

Hora del comentario: 10:17 PM

Comentario: 5. Para la partida 2 del renglón 14 Tubo para sistema y toma de recolección de sangre, de plástico pet al vacío (13x75mm) desechable para adulto con citrato de sodio 0.105 Molar (3.2%) (0.3ml) liquido, tapón azul con silicón como lubricante, volumen

Participante: DICIPA, S.A. DE C.V. (Proveedor_812)

Hora del comentario: 10:18 PM

Comentario: de drenado 2.7 a 3.0 ml (+/- 0.3ml). El rango menor establece el volumen de drenado a la altura del Altiplano Mexicano y el rango mayo el nivel del mar. Con tapón de seguridad, estéril, desechable. Caja con 100, Por su naturaleza biología, se

Participante: DICIPA, S.A. DE C.V. (Proveedor_812)

Hora del comentario: 10:20 PM


Comentario: fabrica con 6 meses de caducidad, respaldados por el registro sanitario, Se acepta entregar esta caducidad?

Participante: DICIPA, S.A. DE C.V. (Proveedor_812)

Hora del comentario: 10:22 PM

Comentario:

Participante: DICIPA, S.A. DE C.V. (Proveedor_812)

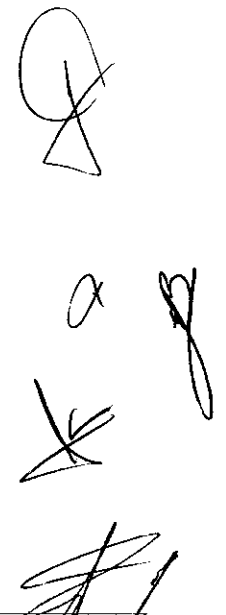

Hora del comentario: 10:34 PM

Comentario: Punto 4 inciso c) Propuesta Técnica punto 7 Documentación que compruebe el domicilio fiscal del licitante, además, deberán comprobar que tengan establecido dentro del área metropolitana del Estado de Nuevo León, Almacén o local de distribución

Participante: DICIPA, S.A. DE C.V. (Proveedor_812)

Hora del comentario: 10:34 PM

Comentario: para atender en el tiempo requerido las necesidades de la Convocante (Alta de Hacienda y Aviso de Funcionamiento o Licencia Sanitaria Vigente).

Participante: DICIPA, S.A. DE C.V. (Proveedor_812)

Hora del comentario: 10:35 PM

Comentario: ¿Para cubrir este punto podemos entregar escrito bajo protesta de decir verdad donde mencionemos que contamos con Almacén dentro del Área Metropolitana del Estado de Nuevo León?

Participante: La Convocante (La Convocante)

Hora del comentario: 09:00 AM

Comentario: ¡FORO ELECTRÓNICO DE ACLARACIONES CERRADO!

El Foro Electrónico de Aclaraciones se dio por concluido el 28/06/2013 a las 09:00 AM horas.

A continuación se dará respuesta a las preguntas presentadas por los licitantes:

LICITANTE: DICIPA, S.A. de C.V.	
DUDAS PRESENTADAS:	
Pregunta 1:	Para el renglón 14, de la partida 2, del Anexo 1, Tubo para la toma y recolección de sangre de vidrio, al vacío (13x100mm) desechable para adulto con citrato de sodio (0.5ml), liquido, tapón azul, el tapón y el interior del tubo recubierto con silicón, volumen de drenado 4.8 – 4.9 ml, +/- 0.3ml. Esta clave ha sido descontinuada y no se encuentra en el mercado, por lo que solicitamos a la convocante se sustituya por la clave 080.909.6555 Tubo para sistema y toma de recolección de sangre de plástico PET al vacío (13x75mm) desechable para adulto con citrato de sodio 0.105 Molar (3.2%) (0.3ml) liquido, tapón azul con silicón como lubricante, volumen de drenado 2.7 a 3.0 ml (+/- 0.3ml). El rango menor establece el volumen de drenado a la altura del Altiplano Mexicano y el rango mayor el nivel del mar. Con tapón de seguridad, estéril, desechable. Caja con 100, Se acepta?
Respuesta:	Si se acepta su solicitud.
Pregunta 2:	Para el renglón 15, de la partida 2, del Anexo 1, Tubo para la toma y recolección de sangre de vidrio al vacío (13x100mm) desechable para adulto, sin anticoagulante, tapón rojo, son silicón como lubricante, volumen de drenado 7ml (+/-0.4ml), por ser material de vidrio y considerado como riesgo de punción accidental a los usuarios, se puede sustituir y/ o agregar la clave 080.909.6506 Tubo sistema para toma y recolección de sangre, de plástico PET al vacío (13 x 100 mm) desechable para adulto sin anticoagulante, tapón rojo con silicón como lubricante y activador de coagulación, volumen de drenado 6 ml (+ 0.3 ml). Etiquetados individualmente con número de lote y fecha de caducidad. Con tapón de seguridad. Estéril. Caja con 100. Se acepta?

Respuesta:	Si se acepta su solicitud.
Pregunta 3:	Para el renglón 18, de la partida 2, del Anexo 1, Tubo para toma y recolección de sangre de vidrio al vacío (13x75mm), desechable, para adulto, con EDTA tripotasico (0.048 ml), liquido, tapón lila con silicón como lubricante volumen de drenado 4.8 -4.9 ml +/- 0.3 ml. Caja con 100, Se ha demostrado que el EDTA tripotasico provoca encogimiento de células por lo que puede alterar las determinaciones hematológicas, solicitamos a la convocante se sustituya por la clave 080.909.6498 Tubo sistema para toma y recolección de sangre, de plástico PET al vacío (13 x 75 mm) desechable para adulto con EDTA K2 (7.2 mg) aplicado por aspersion en la pared del tubo, tapón lila con silicón como lubricante, volumen de drenado 4.0 ml (+ 0.3 ml). Etiquetado individualmente con número de lote y fecha de caducidad. Con tapón de seguridad. Estéril. Caja con 100 tubos. Se acepta?
Respuesta:	Si se acepta su solicitud.
Pregunta 4:	El renglón 11, de la partida 2 tubo de hule para ligar a los pacientes en el momento de puncionar, de látex, color ámbar, diámetro de 5mm, solicitamos a la convocante se sustituya por torniquete strech libre de látex, caja con 25 piezas. Se acepta?
Respuesta:	Si se acepta su solicitud.
Pregunta 5:	Para la partida 2 del renglón 14 Tubo para sistema y toma de recolección de sangre, de plástico pet al vacío (13x75mm) desechable para adulto con citrato de sodio 0.105 Molar (3.2%) (0.3ml) liquido, tapón azul con silicón como lubricante, volumen de drenado 2.7 a 3.0 ml (+/- 0.3ml). El rango menor establece el volumen de drenado a la altura del Altiplano Mexicano y el rango mayor el nivel del mar. Con tapón de seguridad, estéril, desechable. Caja con 100, Por su naturaleza biología, se fabrica con 6 meses de caducidad, respaldados por el registro sanitario, Se acepta entregar esta caducidad?
Respuesta:	Se acepta su solicitud y deberá entregar carta compromiso de que se cambiaran los insumos que no sean consumidos dos meses antes de la fecha de vencimiento de la caducidad.
Pregunta 6:	Punto 4 inciso c) Propuesta Técnica punto 7 Documentación que compruebe el domicilio fiscal del licitante, además, deberán comprobar que tengan establecido dentro del área metropolitana del Estado de Nuevo León, Almacén o local de distribución para atender en el tiempo requerido las necesidades de la Convocante (Alta de Hacienda y Aviso de Funcionamiento o Licencia Sanitaria Vigente) ¿Para cubrir este punto podemos entregar escrito bajo protesta de decir verdad donde mencionemos que contamos con Almacén dentro del Área Metropolitana del Estado de Nuevo León?
Respuesta:	No es suficiente carta compromiso, deberá comprobarlo como se solicita en las bases.

GENERALES




1.- El licitante ganador de la Partida No .2 (Fase Pre-analítica) deberá proporcionar tres dispositivos para la visualización de venas para la toma de muestra para el Hospital Materno- Infantil, Laboratorio Estatal y Hospital Metropolitano.

Su propuesta deberá incluir curso de capacitación de toma de muestra con valor curricular para el Hospital Metropolitano, Hospital Materno-Infantil y Laboratorio Estatal.


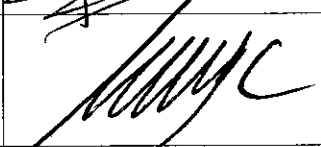

2.- Se informa a los interesados que se modifica la fecha en que se dará a conocer la resolución de adjudicación siendo el lunes 8 de julio del 2013 a las 17:15 Hrs.

De esta manera se da por concluido el foro de aclaraciones de la presente subasta, cuya acta estará disponible para su consulta en el portal de subastas electrónicas del gobierno del estado y en la página oficial de compranet

No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminado el presente evento, siendo las 10:30 horas de la fecha indicada al inicio de esta acta, firmando de conformidad y para constancia legal los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo.

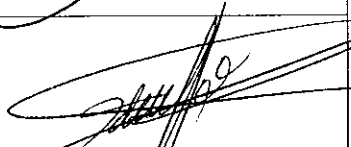MIEMBROS DEL COMITÉ CON VOZ Y VOTO		
	NOMBRE	FIRMA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	LIC. MARIO ALBERTO LIMÓN RODRÍGUEZ	
REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	LIC. JUAN FRANCISCO RODULFO OROPEZA	
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA	LIC. JUAN MANUEL PARRA BURGOS	

DEJANDO SALVAGUARDADAS LAS FACULTADES DE VERIFICACIÓN Y COMPROBACIÓN DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

INVITADOS		
	NOMBRE	FIRMA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES	LIC. FIDEL MOCTEZUMA CARRILLO	
JEFE DEL DEPTO. DE ADQUISICIONES	C.P. GERARDO HEBERTO CERVANTES PADILLA	
UNIDAD DE EVALUACIÓN Y TRANSPARENCIA	C.P. VIRGINIA YANETH BALDERAS MEDINA	

INVITADO DEL ÁREA USUARIA		
UNIDAD	NOMBRE	FIRMA
LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA	Q. HÉCTOR GRACIA LEAL	