

**ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DEL
FORO DE ACLARACIONES DE LA
SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
INTERNACIONALES No. EA-919044992-I35-2013
(S.S.N.L. 30/13)**

“EQUIPO MÉDICO” (APARATO DE RAYOS X PANORÁMICO DIGITAL) 2ª. VUELTA

En la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, siendo las 9:30 horas del día 5 de Agosto del 2013, se reunieron en la sala de juntas de la Subdirección de Recursos Materiales, ubicada en Matamoros No. 520 Ote. Primer piso, centro de la ciudad, para efectuar la celebración del acto de Foro de Aclaraciones a las bases del concurso de la Subasta Electrónica Inversa Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Internacionales No. EA-919044992-I35-2013 referente a la Adquisición de **Equipo Médico (Aparato de Rayos X Panorámico Digital)**, estando presentes los miembros del comité de adquisiciones e invitados que figuran y firman al final de la presente acta.

Este acto fue presidido por el Lic. Mario Alberto Limón Rodríguez, Director Administrativo, quien procede a dar inicio al foro de aclaraciones de conformidad con lo establecido en los artículos 34 y 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León; así como a lo señalado en las bases de la subasta en referencia.

La convocante hace constar que el foro de aclaraciones dio inicio el día 31 de Julio del 2013 a las 9:30 horas, como se establece en la convocatoria y en las bases de la subasta y que se recibieron preguntas a través del portal de subastas electrónicas del gobierno del estado de Nuevo León, por los licitantes que adquirieron sus bases, las cuales se les dará respuesta a las mismas dentro del término establecido, siendo esto conforme a lo siguiente: -----

**GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO
ACTA DEL FORO ELECTRONICO DE ACLARACIONES
SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA No. 289**

El día 31/07/2013 a las 09:30 AM horas se inició el FORO ELECTRÓNICO DE ACLARACIONES de la Subasta Electrónica Inversa No. 289 y número de CompraNet EA-919044992-N35-2013 vía Internet estando registrados los siguientes participantes:

Por parte del Gobierno del Estado de Nuevo León.

Nombre: La Convocante

Que durante la sesión fue identificado como: La Convocante

Hora de Registro: 02/08/2013 09:40:28 AM

Proveedores

Nombre: REPRESENTACIONES MEDICAS RADIOLOGICAS DEL NORTE
S.A. DE C.V.



Que durante la sesión fue identificado como: Proveedor_922

Hora de Registro: 01/08/2013 10:23:57 AM

Nombre: PROMOVARO S.A. DE C.V.

Que durante la sesión fue identificado como: Proveedor_1039

Hora de Registro: 31/07/2013 16:29:15 PM

Durante el Foro Electrónico de Aclaraciones se presentaron los siguientes comentarios:

Participante: PROMOVARO S.A. DE C.V. (Proveedor_1039)

Hora del comentario: 04:29 PM

Comentario: REFERENTE AL NÚMERO DE LICITACIÓN, TENEMOS CONFUSIÓN EL PORQUE EN COMPRANET APARECE CON NÚMERO DE LICITACIÓN No. EA-919044992-I35-2013, Y EN EL PORTAL DE GOBIERNO APARECE COMO EA-919044992-N35-2013

Participante: PROMOVARO S.A. DE C.V. (Proveedor_1039)

Hora del comentario: 04:31 PM

Comentario: EL CORRECTO ES I35?? NOS REGISTRAMOS EN EL PORTAL DE GOBIERNO EN LA N35 QUE ES LA UNICA QUE CONTIENE LOS EQUIPOS RAYOS X QUE VAMOS A COTIZAR, AL MOMENTO DE LA SUBASTA QUE SE LLEVARÁ EL DÍA 12 DE AGOSTO ENTRAREMOS A ES MISMO NÚMERO N35??

Participante: PROMOVARO S.A. DE C.V. (Proveedor_1039)

Hora del comentario: 06:27 PM

Comentario: EL PRECIO DE REFERENCIA QUE SUBIRAN AL PORTAL DE GOBIERNO PARA LA SUBASTA, SERÁ PRECIO NETO O MÁS IV.A.? COTIZAREMOS ANTES DE I.V.A. O DESPUÉS DE I.V.A.?

Participante: REPRESENTACIONES MEDICAS RADIOLOGICAS DEL NORTE S.A. DE C.V. (Proveedor_922)

Hora del comentario: 10:23 AM

Comentario: EL SISTEMA QUE PROPONEMOS ES UN SISTEMA DIGITAL PANORAMICO Y CEFALOMETRICO DE UNA MARCA CON MUCHO PRESTIGIO A NIVEL MUNDIAL, LA CUAL TIENE UN RANGO DE 60 A 90KV Y DE 2 A 15MA. QUE ES MAYOR AL RANGO QUE ESTAN SOLICITANDO. ESTO ES UN BENEFICIO PARA LA


Participante: REPRESENTACIONES MEDICAS RADIOLOGICAS DEL NORTE S.A. DE C.V. (Proveedor_922)

Hora del comentario: 10:25 AM

Comentario: CONVOCANTE Y SU POBLACION DE DERECHOHABIENTES, SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

Participante: REPRESENTACIONES MEDICAS RADIOLOGICAS DEL NORTE S.A. DE C.V. (Proveedor_922)

Hora del comentario: 10:29 AM

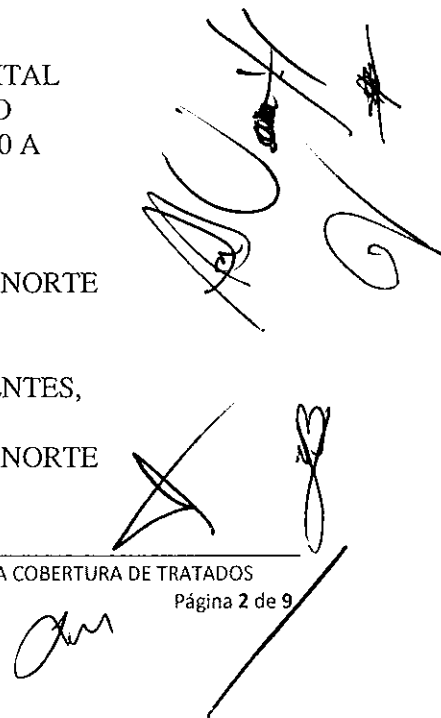

Comentario: LA MAGNIFICACION PANORAMICA DEL EQUIPO QUE PROPONEMOS ES DE 1.5, DANDO COMO RESULTADO MAYOR CALIDAD A LA QUE ESTAN SOLICITANDO Y OTORGA UNA MAGNIFICACION EXCELENTE, SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

Participante: REPRESENTACIONES MEDICAS RADIOLOGICAS DEL NORTE S.A. DE C.V. (Proveedor_922)

Hora del comentario: 10:30 AM

Comentario: LA RESOLUCION DEL EQUIPO QUE PROPONEMOS ES DE 20 LP/MM QUE ES MEJOR QUE EL QUE PIDE LA CONVOCANTE, SE ACEPTA ESTA PETICION?

Participante: REPRESENTACIONES MEDICAS RADIOLOGICAS DEL NORTE S.A. DE C.V. (Proveedor_922)

Hora del comentario: 10:34 AM

Comentario: EL EQUIPO QUE PROPONEMOS ES EL SISTEMA DIGITAL PANORAMICO Y CEFALOMETRICO QUE TIENE UN TIEMPO DE EXPOSICION PARA LOS ESTUDIOS PANORAMICOS DE 4.6 A 13.9 SEGUNDOS, QUE ES MENOR QUE EL QUE SOLICITA LA CONVOCANTE, LO CUAL REDUCE LA RADIACION AÚN MAS QUE

Participante: REPRESENTACIONES MEDICAS RADIOLOGICAS DEL NORTE S.A. DE C.V. (Proveedor_922)

Hora del comentario: 10:35 AM

Comentario: LAS CARACTERISTICAS QUE ESTAN SOLICITANDO, SIENDO UN BENEFICIO DIRECTO PARA EL PACIENTE, SE ACEPTA ESTA PROPUESTA?

Participante: REPRESENTACIONES MEDICAS RADIOLOGICAS DEL NORTE S.A. DE C.V. (Proveedor_922)

Hora del comentario: 10:38 AM

Comentario: EL TIEMPO DE EXPOSICION DEL EQUIPO QUE PROPONEMOS TIENE UN SISTEMA DE UN SOLO DISPARO EN LATERAL DE CRANEO QUE ES DE 1 A 3.2 SEGUNDOS, EL CUAL ES MENOR AL QUE SOLICITA LA CONVOCANTE, REDUCE LA RADIACION Y LA POSIBILIDAD DE QUE SE MUEVA EL PACIENTE


Participante: REPRESENTACIONES MEDICAS RADIOLOGICAS DEL NORTE S.A. DE C.V. (Proveedor_922)

Hora del comentario: 10:39 AM

Comentario: DURANTE LA TOMA, ASI COMO LA DISTORSION EN LA IMAGEN, SE ACEPTA ESTA CARACTERISTICA?

Participante: REPRESENTACIONES MEDICAS RADIOLOGICAS DEL NORTE S.A. DE C.V. (Proveedor_922)

Hora del comentario: 10:42 AM

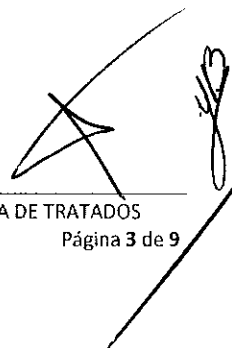

Comentario: LA CONVOCANTE SOLICITA CPU CON SOFTWARE I-DEXEL, QUE SE REFIERE A UNA MARCA ESPECIFICA, NUESTRO EQUIPO OFRECE UN SOFTWARE EN UN CPU, QUE TRBAJE EN RED, QUE PUEDA VISUALIZAR LAS IMAGENES PANORAMICAS Y CEFALOMETRICAS, CON HERRAMIENTAS PARA TOMAR

Participante: REPRESENTACIONES MEDICAS RADIOLOGICAS DEL NORTE S.A. DE C.V. (Proveedor_922)

Hora del comentario: 10:44 AM

Comentario: MEDIDAS, AMPLIACION DE IMAGEN, CONTRASTES, BRILLO, SIMULACION DE IMPLANTES Y TRAZOS CEFALOMETRICOS MANUALES, QUE LE DAN UNAS HERRAMIENTAS TOTALES, SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

Participante: REPRESENTACIONES MEDICAS RADIOLOGICAS DEL NORTE S.A. DE C.V. (Proveedor_922)

Hora del comentario: 10:47 AM

Comentario: LA CONVOCANTE SOLICITA LLAVE INSTALADA, LA LLAVE SE REFIERE A QUE ESTE SOFTWARE REQUIERE LLAVE PARA USARSE COMO UNA CLAVE DE ACTIVACION. LO CUAL ES UNA LIMITANTE PARA EL USUARIO DEL EQUIPO, NOSOTROS PROPONEMOS SOFTWARE SIN LIMITE DE INSTALACIONES Y

Participante: REPRESENTACIONES MEDICAS RADIOLOGICAS DEL NORTE S.A. DE C.V. (Proveedor_922)

Hora del comentario: 10:48 AM

Comentario: SIN LIMITE DE CODIGOS, LO CUAL LE DA MAYOR FUNCIONALIDAD AL EQUIPO, SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

Participante: REPRESENTACIONES MEDICAS RADIOLOGICAS DEL NORTE S.A. DE C.V. (Proveedor_922)


Hora del comentario: 10:51 AM

Comentario: HOY EN DIA SE NECESITA MAYOR CALIDAD, COMODIDAD Y PRECISION POR LO QUE EL EQUIPO QUE PROPONEMOS TIENE 3 POSICIONADORES LASER PARA SACAR UNA PANORAMICA Y UN LASER PARA LA LATERAL DE CRANEO, SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

Participante: REPRESENTACIONES MEDICAS RADIOLOGICAS DEL NORTE S.A. DE C.V. (Proveedor_922)

Hora del comentario: 10:54 AM

Comentario: EL POSICIONAMIENTO CON ESPEJO ES MENOS PRECISO SIENDO UNA TECNICA MUY ANTIGÜA Y CAUSA TENSION EN EL PACIENTE, POR LO QUE EN EL EQUIPO QUE PROPONEMOS, SE POSICIONA AL PACIENTE CARA A CARA PARA VERLO DE FRENTE, SE

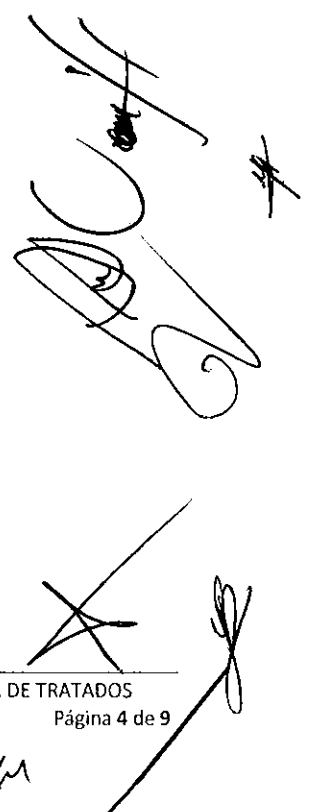

ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

Participante: REPRESENTACIONES MEDICAS RADIOLOGICAS DEL NORTE
S.A. DE C.V. (Proveedor_922)

Hora del comentario: 10:58 AM

Comentario: EN LA ACTUALIDAD DEBEMOS DAR GRAN IMPORTANCIA A NUESTROS HERMANOS DISCAPACITADOS, POR TAL MOTIVO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONSIDERAR EL CAMBIO DE ESPECIFICACION DE DICHO EQUIPO Y QUE LO QUE ADQUIERA SEAN CAPACES DE REALIZAR EL ESTUDIO DE

Participante: REPRESENTACIONES MEDICAS RADIOLOGICAS DEL NORTE
S.A. DE C.V. (Proveedor_922)

Hora del comentario: 11:00 AM

Comentario: RADIOGRAFIAS PANORAMICAS Y CEFALOMETRICAS CON UN ACCESO ESPECIAL PARA SILLA DE RUEDAS, SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

Participante: REPRESENTACIONES MEDICAS RADIOLOGICAS DEL NORTE
S.A. DE C.V. (Proveedor_922)

Hora del comentario: 11:02 AM

Comentario:

Participante: La Convocante (La Convocante)

Hora del comentario: 09:40 AM

Comentario: ¡FORO ELECTRÓNICO DE ACLARACIONES CERRADO!

El Foro Electrónico de Aclaraciones se dio por concluido el 02/08/2013 a las 09:40 AM horas.

A continuación se dará respuesta a las preguntas presentadas por el licitante:

LICITANTE: PROMOVAGO, S. A. DE C. V.	
DUDAS ADMINISTRATIVAS:	
Pregunta 1:	Referente al número de licitación, tenemos confusión por qué en compranet aparece con número de licitación No. EA-919044992-I35-2013, y en el portal de gobierno aparece como EA-919044992-N35-2013, el correcto es I35?? Nos registramos en el portal de gobierno en la N35 que es la única que contiene los equipos rayos x que vamos a cotizar, al momento de la subasta que se llevará el día 12 de agosto entraremos a ese mismo número N35?
Respuesta:	El número correcto para el desarrollo de la subasta es EA-919044992-I35-2013 siendo el mismo concurso que aparece en el portal de subastas como No. EA-919044992-N35-2013.

Pregunta 2:	El precio de referencia que subirán al portal de Gobierno para la subasta, será precio neto o más i.v.a.? Cotizaremos antes de i.v.a. o después de i.v.a.?
Respuesta:	El precio de referencia en el portal de subastas electrónicas de gobierno del Estado de Nuevo León es antes de i.v.a. de igual forma deberá presentar su propuesta económica.

LICITANTE: REPRESENTACIONES MEDICAS RADIOLÓGICAS DEL NORTE, S. A. DE C. V.	
DUDAS TÉCNICAS:	
Pregunta 1:	El sistema que proponemos es un sistema digital panorámico y cefalometrico de una marca con mucho prestigio a nivel mundial, la cual tiene un rango de 60 a 90kv y de 2 a 15ma. que es mayor al rango que están solicitando. Esto es un beneficio para la convocante y su población de derechohabientes, se acepta nuestra propuesta?
Respuesta:	Si, se acepta su propuesta, siempre y cuando cumpla con las características solicitadas en el anexo 1.
Pregunta 2:	La magnificación panorámica del equipo que proponemos es de 1.5, dando como resultado mayor calidad a la que están solicitando y otorga una magnificación excelente, se acepta nuestra propuesta?
Respuesta:	Si, se acepta su propuesta, siempre y cuando cumpla con las características solicitadas en el anexo 1.
Pregunta 3:	La resolución del equipo que proponemos es de 20 lp/mm que es mejor que el que pide la convocante, se acepta esta petición?
Respuesta:	Si, se acepta su propuesta, siempre y cuando cumpla con las características solicitadas en el anexo 1.
Pregunta 4:	El equipo que proponemos es el sistema digital panorámico y cefalometrico que tiene un tiempo de exposición para los estudios panorámicos de 4.6 a 13.9 segundos, que es menor que el que solicita la convocante, lo cual reduce la radiación aún más que las características que están solicitando, siendo un beneficio directo para el paciente, se acepta esta propuesta?
Respuesta:	Si, se acepta su propuesta, siempre y cuando cumpla con las características solicitadas en el anexo 1.
Pregunta 5:	El tiempo de exposición del equipo que proponemos tiene un sistema de un solo disparo en lateral de cráneo que es de 1 a 3.2 segundos, el cual es menor al que solicita la convocante, reduce la radiación y la posibilidad de que se mueva el paciente durante la toma, así como la distorsión en la imagen, se acepta esta característica?
Respuesta:	Si, se acepta su propuesta, siempre y cuando cumpla con las características solicitadas en el anexo 1.
Pregunta 6:	La convocante solicita cpu con software i-dixel, que se refiere a una marca específica, nuestro equipo ofrece un software en un cpu, que trabaje en red, que pueda visualizar las imágenes panorámicas y cefalometricas, con herramientas para tomar medidas, ampliación de imagen, contrastes, brillo, simulación de

	implantes y trazos cefalometricos manuales, que le dan unas herramientas totales, se acepta nuestra propuesta?
Respuesta:	Si, se acepta su propuesta, siempre y cuando cumpla con las características solicitadas en el anexo 1.
Pregunta 7:	La convocante solicita llave instalada, la llave se refiere a que este software requiere llave para usarse como una clave de activación. lo cual es una limitante para el usuario del equipo, nosotros proponemos software sin límite de instalaciones y sin límite de códigos, lo cual le da mayor funcionalidad al equipo, se acepta nuestra propuesta?
Respuesta:	Si, se acepta su propuesta, siempre y cuando cumpla con las características solicitadas en el anexo 1.
Pregunta 8:	Hoy en día se necesita mayor calidad, comodidad y precisión por lo que el equipo que proponemos tiene 3 posicionadores laser para sacar una panorámica y un laser para la lateral de cráneo, se acepta nuestra propuesta?
Respuesta:	Si, se acepta su propuesta, siempre y cuando cumpla con las características solicitadas en el anexo 1.
Pregunta 9:	El posicionamiento con espejo es menos preciso siendo una técnica muy antigua y causa tensión en el paciente, por lo que en el equipo que proponemos, se posiciona al paciente cara a cara para verlo de frente, se acepta nuestra propuesta?
Respuesta:	Si, se acepta su propuesta, siempre y cuando cumpla con las características solicitadas en el anexo 1.
Pregunta 10:	En la actualidad debemos dar gran importancia a nuestros hermanos discapacitados, por tal motivo, solicitamos a la convocante considerar el cambio de especificación de dicho equipo y que lo que adquiera sean capaces de realizar el estudio de radiografías panorámicas y cefalometricas con un acceso especial para silla de ruedas, se acepta nuestra propuesta?
Respuesta:	Si, se acepta su propuesta, siempre y cuando cumpla con las características solicitadas en el anexo 1.

De esta manera se da por concluido el foro de aclaraciones de la presente subasta, cuya acta estará disponible para su consulta en el portal de subastas electrónicas del gobierno del estado y en la página oficial de compranet.

No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminado el presente evento, siendo las 11:30 horas de la fecha indicada al inicio de esta acta, firmando de conformidad y para constancia legal los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo.

MIEMBROS DEL COMITÉ CON VOZ Y VOTO		
	NOMBRE	FIRMA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO	LIC. MARIO ALBERTO LIMÓN RODRÍGUEZ	
REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	C.P. PEDRO ANTONIO VALADES RODRÍGUEZ	
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA	LIC. MARÍA DEL CARMEN MOLINA FLORES	

DEJANDO SALVAGUARDAR LAS FACULTADES DE VERIFICACIÓN Y COMPROBACIÓN DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

INVITADOS		
	NOMBRE	FIRMA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES	LIC. FIDEL MOCTEZUMA CARRILLO	
JEFE DEL DEPTO. DE ADQUISICIONES	C.P. GERARDO HEBERTO CERVANTES PADILLA	
UNIDAD DE EVALUACIÓN Y TRANSPARENCIA	C.P. VIRGINIA YANETH BALDERAS MEDINA	

Handwritten signature

INVITADO DEL ÁREA USUARIA		
UNIDAD	NOMBRE	FIRMA
CENTRO DE ESPECIALIDADES DENTALES	DR. SERGIO SAN VICENTE GARCÍA	